

JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）xxx—202x

陶瓷窑炉用水煤气流量计在 线校准规范

Online Calibration Specification of Water Gas Flowmeter for

Ceramic Kiln


（征求意见稿）

××××-××-×× 发布

××××-××-×× 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

陶瓷窑炉用水煤气流量计在线 校准规范

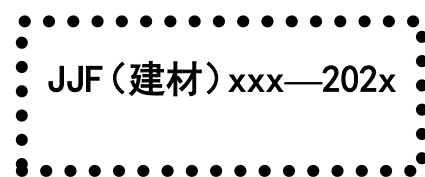

On Line Calibration Specification of Water Gas Flowmeter
for Ceramic Kiln

本规范经中华人民共和国工业和信息化部于 XXXX 年 XX 月 XX 日批准，
并自 XXXX 年 XX 月 XX 日起实施。

归口单位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

参加起草单位：XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

参加起草人：

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

XXX (XXXXXXXXXX)

引 言

本规范以 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》为基础性规范进行编写。

本规范结合陶瓷窑炉用水煤气流量计的实际应用情况而制定，参考了 JJG 643《标准表法流量标准装置检定规程》、JJG 1030《超声流量计检定规程》对测量标准计量性能的要求及 GB/T 18604《用气体超声流量计测量天然气流量》对检定环境条件的要求。

本规范为首次发布。

陶瓷窑炉用水煤气流量计在线校准规范

1 范围

本规范适用于陶瓷窑炉用水煤气流量计的在线校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 643 标准表法流量标准装置

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJG 1030 超声流量计检定规程

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18604 用气体超声流量计测量天然气流量

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 在线校准 (on line calibration)

确定实际工作条件下流量计所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.2 标准表 (standard meter)

用作标准器，其给出的结果作为参考量值。标准表可以是外夹式超声流量计、科里奥利质量流量计等。

3.3 标准直管段 (standard straight pipeline)

用耐腐蚀性较强的材质制作的、适合标准表安装的、可以准确测量的一段管道。

3.4 在线校准装置 (on line calibration device)

能对水煤气流量计进行在线校准、可提供准确流量值且可移动的测量系统。

3.5 标准表法 (standard meter method)

以标准表为标准器，使流体在相同时间间隔内连续通过标准表和水煤气流量计，比较两者的输出流量值，从而确定水煤气流量计与标准表所复现的流量值之间的关系。

3.6 流量计特征系数（meter characteristic coefficient）

可通过修改其数值而改变流量计计量性能的参数。

注：1) 由于各厂家生产流量计工艺不同或名称不同，该参数可能为传感器系数、转换器系数、修正系数或其他参数；2) 该参数可能由一个或一组参数构成。

4 概述

4.1 水煤气流量计

流量计是指示被测流体流量和（或）在选定的时间间隔内流体总量的仪表，在建材工业中广泛用于水煤气、天然气等能源物质计量。

陶瓷窑炉用水煤气流量计，根据测量原理进行分类，有利用流体动量原理的数显靶式流量计、利用流体振荡原理的涡街流量计、利用伯努利定理差压式智能弯管流量计等。

陶瓷窑炉用水煤气流量计由一次装置和二次装置组成，按一次装置和二次装置的组合型式流量计可分为一体型和分体型。

陶瓷窑炉用水煤气流量计主要用于测量水煤气的瞬时流量和累积流量。

5 计量特性

5.1 示值误差

水煤气流量计示值误差通常用相对误差表示，示值最大允许误差见表 1。

表 1 水煤气流量计最大允许误差

准确度等级	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
最大允许误差	$\pm 0.5\%$	$\pm 1.0\%$	$\pm 1.5\%$	$\pm 2.0\%$	$\pm 2.5\%$

5.2 重复性

水煤气流量计的重复性应不超过相应准确度等级规定的最大允许误差限绝对值的1/2。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境条件一般应满足：

环境温度：（0～45）℃；

相对湿度：（35～95）%；

大气压力：（86～106）kPa。

6.1.2 在防爆区域开展在线校准工作时，所有设备设施及工具应符合相关安全防爆要求。

6.1.3 电源满足现场工况要求。

6.1.4 场地满足安全操作要求。

6.1.5 外界磁场对标准器和被校水煤气流量计的影响可忽略。

6.1.6 机械振动和噪声对标准器和被校水煤气流量计的影响可忽略。

6.1.7 直管段应满足被校水煤气流量计对直管段的要求。

6.2 主要设备及配套设备

主要设备和配套设备应具有有效溯源证书，具体要求如表2所示。

表 2 校准用仪器设备

校准方法	设备名称		测量范围	最大允许误差 或准确度等级
标准表法 （串联移动式在线校准装置）	主要设备	校准装置流量范围应与被校水煤气流量计的流量范围相适应，校准装置的扩展不确定度应小于或等于被校水煤气流量计最大允许误差绝对值的 1/2。		
	配套设备	压力测量、数据采集、信号处理、数据处理及通讯不确定度所引起的流量测量不确定度应不超过在线校准装置扩展不确定度的 1/5。否则，装置合成标准不确定度应考虑压力测量、数据采集、信号处理、 数据处理及通讯所引起的不确定度。		
标准表法 （外夹式超声流量计）	主要设备	超声流量计	DN(50~3000)mm	不低于 0.5 级
	配套设备	游标卡尺	300mm	±0.04mm
		钢卷尺	20m	不低于 1 级
		电子秒表	0~1h	±0.1s
		测厚仪	0~100mm	±0.1mm

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

示值误差和重复性。

7.2 校准方法

7.2.1 标准表法（串联移动式在线校准装置）

采用计量准确度高的流量计作为标准表的移动式在线校准装置（以下简称移动式装置），适用于口径为 DN(10~100)mm 的水煤气流量计在线校准。

7.2.1.1 移动式装置的组成和特点

移动式装置主要由标准流量计、压力变送器、试验管路与阀门、信号处理与控制系统等组成，具有结构紧凑、易于移动、适合现场使用等特点。串联移动式装置校准图如图 1 所示。

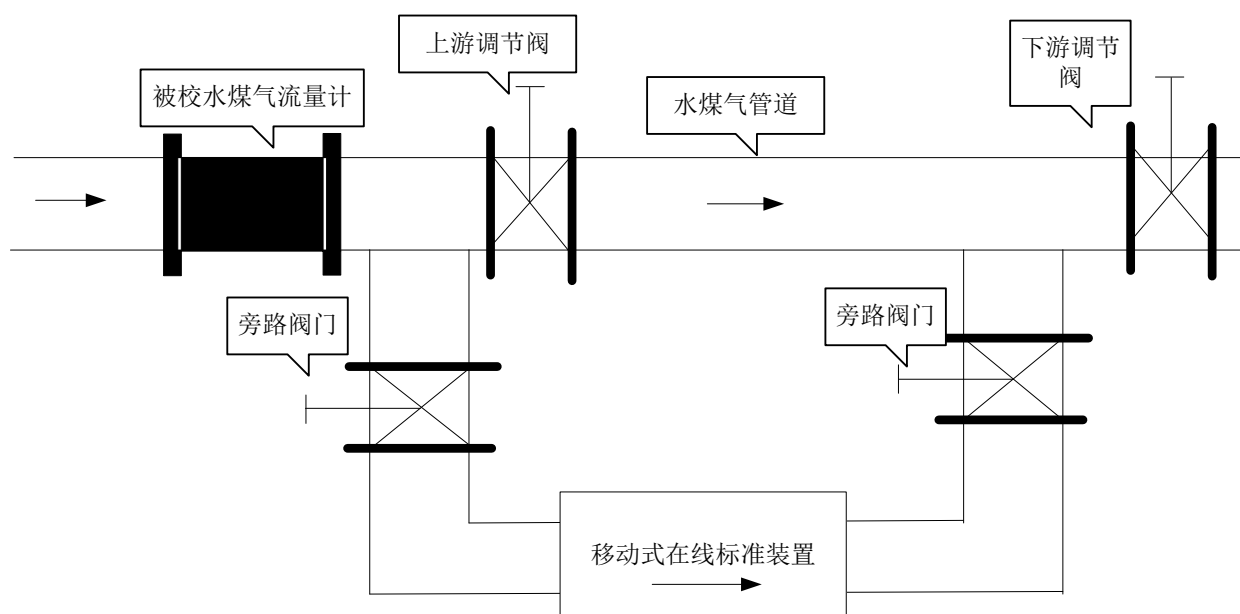


图 1 串联移动式装置校准图

(1) 系统组成与工作原理

移动式装置的工作原理是基于流体力学的连续性方程，将移动式装置与试验管路串联，以其中的标准表为标准器，使流体在相同时间间隔内连续通过标准流量计和被校水煤气流量计，比较二者输出的流量值，从而确定被校水煤气流量计的计量性能。

(2) 使用方法

a) 将移动式装置与被校水煤气流量计旁路管道口连接，关闭被校水煤气流量计下游第一个阀门，打开旁路阀门及移动式装置所有标准流量计所在管路阀门，使移动式装置与被

校水煤气流量计串联连接。

b) 根据现场实际工作条件下的流量大小,使工作介质同时流过被校水煤气流量计和标准流量计。

c) 在校准前,应按使用要求对被校水煤气流量计和标准流量计进行零点调整,调整时传感器测量工作介质应处于静止状态。

d) 操作调节阀,使流量达到实际工作条件下的流量点,稳定一段时间后开始校准,同步记录标准流量计和被校水煤气流量计的初始输出值,经过设定的一段时间后,再记录相应的输出值。

(3) 注意事项

a) 在校准过程中 开闭截止阀或旁路阀门需缓慢操作。

b) 移动式装置应在校准的流量范围内使用,工作压力不得超过设计值。

c) 校准时严禁移动式装置和工艺管线排污或放空。

d) 操作人员必须在现场随时监控移动式装置的运行状态:移动式装置是否稳固、系统管线有无泄漏、仪表和阀门运行是否正常、控制系统运行是否稳定。如有异常应立即通知工艺操作人员采取停机等措施,排除异常后方可继续校准。

e) 校准结束后,排空移动式装置和连接管道内工作介质,确认安全后方可移动装置。

7.2.1.2 校准准备工作

(1) 将移动式装置移至校准现场,确认其外观正常、连接稳固、电源断开、阀门处于关闭状态。

(2) 将移动式装置与在线的被校水煤气流量计串联连接,确认整个管道及连接部位牢固无泄漏,确认供电电源正常,压力变送器、控制设备、调节阀及测量设备等与电源连接正常。

(3) 开启移动装置,在被校水煤气流量计实际工作的流量点运行一段时间(一般不少于 5 min),保证校准管线和流量计充满水煤气,然后停止运行,关闭所有标准流量计所在管路阀门,按照被校水煤气流量计的使用说明书进行零点调整。

7.2.1.3 示值误差校准

(1) 根据被校水煤气流量计的流量范围,调节流量至现场实际工作所需的校准点或客户指定校准点,待流量稳定后同步采集标准流量计和被校水煤气流量计信号,记录被校水

煤气流量计累积流量 Q_1 和标准流量计累积流量 Q_{s1} , 经过一定的校准时间 t 后停止采集, 记录被校水煤气流量计累积流量 Q_2 和标准流量计累积流量 Q_{s2} , 完成 1 次校准。

(2) 每个流量点校准 3 次。

(3) 其它流量点按照上述 (1) 和 (2) 步骤进行, 直到完成全部校准。

单次校准累积流量示值误差为:

$$E_{ij} = \frac{(Q_2 - Q_1) - (Q_{s2} - Q_{s1})}{(Q_{s2} - Q_{s1})} \times 100\% \quad (1)$$

水煤气流量计第 i 流量点示值误差按式 (2) 计算。

$$E_i = \frac{\sum_{j=1}^n E_{ij}}{n} \quad (2)$$

式中:

n —第 i 流量点的校准次数, $n \geq 3$ 。

水煤气流量计示值误差按式 (3) 计算。

$$E = (E_i)_{\max} \quad (3)$$

式中:

$(E_i)_{\max}$ —取各流量点示值误差的最大值。

7.2.1.4 重复性校准

水煤气流量计第 i 流量点重复性 $(E_r)_i$ 按式 (4) 计算

$$(E_r)_i = \frac{(E_{ij})_{\max} - (E_{ij})_{\min}}{d_n} \quad (4)$$

式中:

$(E_{ij})_{\max}$ —取第 i 流量点示值误差的最大值;

$(E_{ij})_{\min}$ —取第 i 流量点示值误差的最小值;

d_n —极差系数。

极差系数值见表 3。

表3 d_n 数值表

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_n	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08

水煤气流量计重复性按式 (5) 计算。

$$E_r = [(E_r)_i]_{\max} \quad (5)$$

式中:

$[(E_r)_i]_{\max}$ —取各流量点重复性的最大值。

7.2.2 标准表法（外夹式超声流量计）

采用外夹式超声流量计作为标准表，适用于口径为 DN50mm 以上的水煤气流量计在线校准。

7.2.2.1 标准表的溯源和使用要求

应对标准表超声流量计所有换能器进行溯源，溯源的流量范围应覆盖被校水煤气流量计现场校准的流量范围。标准表现场使用应有满足要求的直管段，并与被校水煤气流量计进行串联安装。

7.2.2.2 管径测量

用量具在标准表换能器安装位置附近的同一截面上等角分布测量 m 次外直径，或测量 m 次外周长计算出外直径，其平均值 D 按式（6）计算：

$$D = \frac{\sum_{i=1}^m D_i}{m} \quad (6)$$

式中:

m —测量次数， $m \geq 4$;

D_i —第 i 点测得的管道外直径或计算出的外直径。

7.2.2.3 壁厚测量

在标准表每个换能器安装位置上的四角和中间分布 5 个点，使用测厚仪测量管道壁厚，并取其平均值。

7.2.2.4 安装距离

将以上管道参数输入标准表内，得出标准表换能器安装距离 L 。

7.2.2.5 其它情况

对无法测量的参数，如管道材质、衬里材料、厚度等，根据技术资料现场确认。

7.2.2.6 标准表的安装

(1) 安装位置

换能器安装在水煤气流量计上游或下游直管侧（上游直管段一般大于 $10D$ ；下游直管段一般大于 $5D$ ），当上游有阀门等阻件时，直管段长度至少还要延长 $3D \sim 5D$ ，当安装位置不满足直管段要求时，须在校准报告中注明。注意避开可能产生电磁干扰或外部管径锈

蚀严重的位置。标准表法（外夹式超声流量计）工作原理如图 2 所示。

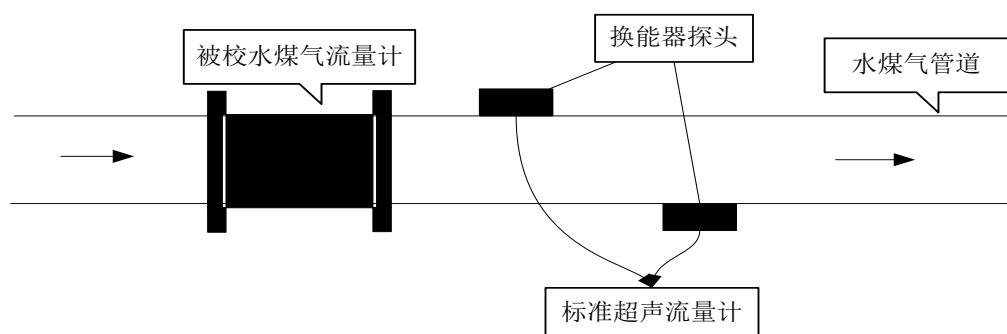


图 2 标准表法（外夹式超声流量计）工作原理图

(2) 调整和校验

将信号调试到最佳状态，一般应包括：

- a) 零点检查：具备停流条件的管道，检查流量计的零点流量；不具备静态零点检查设定条件时，可进行动态零点检查设定。零点调整包括自动调零和手动零点偏移设置；
- b) 阻尼设定：适当的阻尼设定可用来精确观察测量值的变化过程；
- c) 其它工作参数的设定：如有必要可设定模拟输出、显示单位、流量范围、报警信息等内容。

7.2.2.7 示值误差校准

(1) 根据现场实际情况确定校准流量点，每个流量点校准次数不少于 3 次。现场无法调节流量时可采用在不同的时段进行校准。流量点一般选择 1~3 个。

(2) 每次校准，当标准流量计的流量稳定，其流量最大值与最小值之差小于 5% 时，同时读取并记录水煤气流量计和标准流量计的示值。标准流量计应使用自动采集信号的方式，读取一段时间的瞬时流量平均值或累积流量。若读取的数值为瞬时流量，被校水煤气流量计应每隔 10s 进行读数，至少读取 20 个数值，取其平均值；若读取的数值为累积流量，水煤气流量计应保证大于最小读数的 1000 倍或读数至少 10min 的累积流量。

(3) 水煤气流量计每个流量点单次校准的示值相对误差 E_{ij} 按式 (7) 计算。

$$E_{ij} = \frac{q_{ij} - (q_s)_{ij}}{(q_s)_{ij}} \times 100\% \quad (7)$$

式中：

q_{ij} —第 i 流量点第 j 次校准时的水煤气流量计示值（瞬时或累积质量流量）；

$(q_s)_{ij}$ —第 i 流量点第 j 次校准时的标准流量值（瞬时或累积质量流量）。

水煤气流量计第 i 流量点示值误差按式（2）计算。

水煤气流量计示值误差按式（3）计算。

7.2.2.8 重复性校准

水煤气流量计第 i 流量点重复性按式（4）计算。

水煤气流量计重复性按式（5）计算。

8 校准结果表达

经校准的水煤气流量计出具校准证书，校准证书应给出各校准项目的测量结果和示值误差、测量结果的扩展不确定度。

9 复校时间间隔

陶瓷窑炉用水煤气流量计的复校时间间隔由被校单位根据实际使用情况确定，复校时间间隔不宜超过 1 年。

附录 A

校准证书内页格式

设备名称		设备编号			
使用地点		校准日期			
校准依据的技术文件	陶瓷窑炉用水煤气流量计在线校准规范				
环境条件	温度(℃):	湿度(%RH):			
校准地点					
本次校准所用计量器具					
名称/型号	编号	证书编号	证书有效期		
示值误差和重复性					
序号	流量点 (kg/min)	被校流量计 示值(kg/min)	标准示值 (kg/min)	示值误差 (kg/min)	重复性(%)
1					
2					
3					
校准结果的扩展不确定度: $U_{rel} =$, $k=2$					

说明: 1、建议复校时间间隔: 个月

校准员: 核验员:

附录 B

校准数据原始记录

记录编号:

委托单位:		地址:						
被校流量计	名称:	型号:			编号:			
	制造单位:	准确度等级:			校准地点:			
	规格: mm	管道外径: mm			管道壁厚: mm			
	流量范围:	特征系数:						
校验方法		标准表法(移动式装置) ☐			标准表法(超声波) ☐			
计量标准器	型号规格	不确定度或准确度等级或最大允许误差		名称/型号	编号	测量范围		
环境条件	温度:		相对湿度:		校准地点:			
介质参数	介质温度		介质压力:		介质密度:			
校准依据								
序号	流量点	被校流量计示值	标准示值			示值误差	平均误差	重复性
	(kg/min)	(□kg□kg/min)	质量 (t)	时间 (s)	流量值 (□kg□kg/min)	(%)	(%)	(%)
1								
2								
3								
不确定度评定过程		扩展不确定度 $U_{rel} =$, ($k=2$)						
备注		建议复校时间间隔: 个月。						

校准:

核验:

校准日期:

年

月

日

附录 C

采用标准表法（串联移动式在线校准装置）校准结果的不确定度分析实例

C.1 概述

C.1.1 校准方法：采用7.2.1中标准表法（串联移动式在线校准装置）校准。

C.1.2 环境条件：环境温度20℃，相对湿度30%RH。

C.1.3 被校准流量计：测量范围为(0~10) kg/min，准确度等级1.5级的DN80水煤气流量计。

C.1.4 校准用标准器具：串联移动式在线校准装置。

用串联移动式在线校准装置校准DN80水煤气流量计，校准流量点4.0kg/min，被校水煤气流量计累积量 $Q=81.101\text{kg}$ ，标准累积量 $Q_s=80.010\text{kg}$ ，检测时间1200.1s。

C.2 数学模型

C.2.1 被校水煤气流量计的相对示值误差 E 按式（C.1）计算：

$$E = (q - q_s)/q_s \times 100\% \text{ 或 } E = (Q - Q_s)/Q_s \times 100\% \quad (\text{C.1})$$

式中：

q 、 Q ——被校水煤气流量计瞬时值或累积值；

q_s 、 Q_s ——标准装置瞬时值或累积值。

C.2.2 不确定度传播律：

$$u_c^2(E) = C_1^2 u^2(q) + C_2^2 u^2(q_s) \text{ 或 } u_c^2(E) = C_1^2 u^2(Q) + C_2^2 u^2(Q_s) \quad (\text{C.2})$$

式中：

$$C_1 = 1/q_s ; C_2 = -q/q_s^2 \text{ 或 } C_1 = 1/Q_s ; C_2 = -Q/Q_s^2$$

C.3 不确定来源分析

经分析，测量不确定度的主要来源有计量标准器的不确定度、被校水煤气流量计的测量重复性、分辨力和介质压力变化等综合影响等组成。由于数据采集、信号处理及数据处理的不确定度所引起的测量不确定度相对于其他各不确定度分量很小，故忽略不计。

C.4 不确定度分量评定

C.4.1 各种不确定度分量的计算

C.4.1.1 计量标准器带来的标准不确定度 $u(Q_s)$

采用移动式装置作为标准装置,移动式装置准确度 0.5 级,即最大允许误差限为 $\pm 0.5\%$,采用 B 类方法评定,服从均匀分布,包含因子 $k=\sqrt{3}$ 。

$$u(Q_s) = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = 0.29\%$$

C.4.1.2 被校水煤气流量计的不确定度 $u(Q)$ C.4.1.2.1 测量重复性引入的不确定度分量 $u(rep)$

在规定流量点下,对被校水煤气流量计连续重复测量 3 次,得到测量误差数据列为 0.56%、0.89%、0.98%,采用 A 类方法评定。

$$\text{示值平均误差: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0.81\%$$

$$\text{单次实验标准差: } s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.25\%$$

$$\text{标准不确定度: } u(rep) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = 0.14\%$$

C.4.1.2.2 标准器与被校流量计不同步引入的不确定度分量 $u(\Delta t)$

估计此值在 $\pm 0.5s$,服从均匀分布,引入的不确定度为:

$$u(\Delta t) = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289s$$

$$u_r(\Delta t) = \frac{0.289}{1200.1} = 0.0241\%$$

C.4.1.2.3 综合影响引起的不确定度分量 $u_2(Q)$

考虑到标准流量计与被校水煤气流量计由于介质密度、压力变化等综合影响,测量误差经长期实验其影响量小于 0.2%,服从均匀分布,包含因子 $k=\sqrt{3}$ 。

$$u_2(Q) = \frac{0.1\%}{\sqrt{3}} = 0.058\%$$

C.4.1.2.4 标准不确定度 $u(Q)$

$$u(Q) = \sqrt{u^2(rep) + u_r^2(\Delta t) + u_2^2(Q)} = \sqrt{(0.14\%)^2 + (0.0241\%)^2 + (0.058\%)^2} \times 100\% \\ \approx 0.153\%$$

C.4.2 合成标准不确定度 $u_c(E)$

C.4.2.1 标准不确定度汇总表 (见表 C.1)。

表C.1 标准不确定度一览表

序号	不确定度分量符号	不确定度来源	分布, k 值	标准不确定度 $u(x)$	灵敏系数	标准不确定度 $ C \cdot u(x)$
1	$u(Q_s)$	标准器带来的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	$0.29\%Q_s$	$1/Q_s$	0.29%
2	$u(Q)$	被检器带来的不确定度	正态, $k=2$	$0.153\%Q$	$-Q/Q_s^2$	0.153%
2.1	$u(rep)$	重复性引入的不确定度	/	0.14%	1	0.14%
2.2	$u_2(Q)$	综合影响引起的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.058%	1	0.058%
3	合成标准不确定度 $u_c(E)=0.33\%$					
4	扩展不确定度 $U(E)=0.66\%$, $k=2$					

C.4.2.2 合成标准不确定度 $u_c(E)$

以上各标准不确定度分量相互无关, 合成标准不确定度为:

$$u_c(E) = \sqrt{C_1^2 u^2(Q) + C_2^2 u^2(Q_s)} = \sqrt{(0.153\%)^2 + (0.29\%)^2} \times 100\% \approx 0.33\%$$

C.4.3 校准结果的扩展不确定度 U

取 $k=2$, 采用标准表法 (串联移动式在线校准装置) 校准结果的扩展不确定度为:

$$U = k u_c(E) = 2 \times 0.33\% = 0.66\%, \quad k=2。$$

附录 D

采用标准表法（外夹式超声流量计）校准结果的不确定度分析实例

D.1 概述

D.1.1 校准方法：采用7.2.2中标准表法（外夹式超声流量计）校准。

D.1.2 环境条件：环境温度20℃，相对湿度30%RH。

D.1.3 被校准设备：测量范围为(0~10) kg/min，准确度等级1.5级的DN80水煤气流量计。

D.1.4 校准用标准器具：准确度等级0.5级的外夹式超声流量计。

用外夹式超声流量计校准DN80水煤气流量计，校准流量点4.0kg/min，被校水煤气流量计累积量 $Q=81.101\text{kg}$ ，标准累积量 $Q_s=80.010\text{kg}$ ，检测时间1200.1s。

D.2 数学模型

D.2.1 被校水煤气流量计的相对示值误差 E 按式（D.1）计算：

$$E = (q - q_s)/q_s \times 100\% \text{ 或 } E = (Q - Q_s)/Q_s \times 100\% \quad (\text{D.1})$$

式中：

q 、 Q ——被校流量计瞬时值或累积值；

q_s 、 Q_s ——标准表瞬时值或累积值。

D.2.2 不确定度传播律：

$$u_c^2(E) = C_1^2 u^2(q) + C_2^2 u^2(q_s) \text{ 或 } u_c^2(E) = C_1^2 u^2(Q) + C_2^2 u^2(Q_s) \quad (\text{D.2})$$

式中：

$$C_1 = 1/q_s ; C_2 = -q/q_s^2 \text{ 或 } C_1 = 1/Q_s ; C_2 = -Q/Q_s^2$$

D.3 不确定来源分析

经分析，测量不确定度的主要来源有标准器及检测方法、检测条件带来的不确定度、被校水煤气流量计分辨力、测量重复性等因素带来的不确定度分量。

D.4 不确定度分量评定

D.4.1 各种不确定度分量的计算

D.4.1.1 标准器及检测方法、检测条件带来的不确定度 $u(Q_s)$

超声流量计计算公式:

$$q_s = \frac{v}{K} \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

$$Q_s = q_s \cdot t = \frac{v \pi d^2}{K} t$$

$$u_r^2(Q_s) = u_r^2(v) + 4u_r^2(d) + u_r^2(\Delta t) + u_r^2(x)$$

式中:

v ——声道上线平均速度;

K ——流速分布修正系数;

d ——管道内径;

$u_r(v)$ ——标准器流速测量准确度所带来的影响相对量, 也即 $u(\Delta)$;

$u_r(d)$ ——测量管径准确性带来的影响相对量;

$u_r(t)$ ——标准器检测时间准确性所带来的影响相对量;

$u_r(\Delta t)$ ——标准器与被检器起停不同步带来的影响相对量;

$u_r(x)$ ——其它环节带来的影响相对量, 包括流速的稳定性、换能器耦合的可靠性、被检水煤气流量计安装的合理性(对中、前后直管段长度、可靠接地等)、介质条件。现场要求尽量减小这些方面因素的影响。

D.4.1.1.1 标准器引入的不确定度分量 $u(v)$

标准超声流量计准确度 0.5 级, 服从均匀分布, 引入的标准不确定度为:

$$u(\Delta) = u(v) = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \times 80.010 = 0.231\text{kg}$$

$$u_r(v) = \frac{0.231}{80.010} = 0.289\%$$

D.4.1.1.2 管径测量引入的不确定度分量 $u(d)$

一般测量准确度在 $\pm 0.5\text{mm}$, 服从均匀分布, 引入的标准不确定度为:

$$u(d) = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289\text{mm}$$

$$u_r(d) = \frac{0.289}{80} = 0.361\%$$

D.4.1.1.3 标准器检测时间引入的不确定度分量 $u(t)$

估计此值在 $\pm 0.1\text{s}$, 服从均匀分布, 引入的标准不确定度为:

$$u(t) = \frac{0.1}{\sqrt{3}} = 0.058s$$

$$u_r(t) = \frac{0.058}{1200.1} = 0.0048\%$$

D.4.1.1.4 标准器与被校流量计不同步引入的不确定度分量 $u(\Delta t)$

估计此值在 $\pm 0.5s$ ，服从均匀分布，引入的不确定度为：

$$u(\Delta t) = \frac{0.5}{\sqrt{3}} = 0.289s$$

$$u_r(\Delta t) = \frac{0.289}{1200.1} = 0.0241\%$$

D.4.1.1.5 其它因素引入的不确定度分量 $u(x)$

估计所带来的影响在 $\pm 0.5\%$ 之间，服从均匀分布，引入的不确定度：

$$u(x) = \frac{0.005}{\sqrt{3}} \times 80.010 = 0.231kg$$

$$u_r(x) = \frac{0.231}{80.010} = 0.361\%$$

D.4.1.1.6 综上所述

$$\begin{aligned} u_r(Q_s) &= \sqrt{u_r^2(v) + 4u_r^2(d) + u_r^2(t) + u_r^2(\Delta t) + u_r^2(x)} \\ &= \sqrt{(0.289\%)^2 + 4 \times (0.361\%)^2 + (0.0048\%)^2 + (0.0241\%)^2 + (0.361\%)^2} \\ &= 0.858\% \end{aligned}$$

$$u(Q_s) = 0.858\% \times 80.010 = 0.686kg$$

D.4.1.2 被校水煤气流量计的不确定度 $u(Q)$

$$u^2(Q) = u^2(\delta) + u^2(rep)$$

D.4.1.2.1 被校水煤气流量计分辨力引入的不确定度分量 $u(\delta)$

被校流量计分辨力为 $0.001kg$ ，服从均匀分布，引起的不确定度为：

$$u(\delta) = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006kg$$

D.4.1.2.2 测量重复性引入的不确定度分量 $u(rep)$

现场连续检测 3 次，3 次检测结果得到示值误差重复性为 0.22% ，则： $u(rep) = 0.22\% \times 81.101 = 0.178kg$

D.4.1.2.3 综上所述

$$u(Q) = \sqrt{u^2(\delta) + u^2(rep)} = \sqrt{(0.0006)^2 + (0.178)^2} = 0.178kg$$

D.4.2 合成标准不确定度 $u_c(E)$

D.4.2.1 标准不确定度一览表见表 D.1

表D.1 标准不确定度一览表

序号	不确定度分量符号	不确定度来源	分布, k 值	标准不确定度 $u(x)$	灵敏系数	标准不确定度 $ C \cdot u(x)$
1	$u(Q_s)$	标准器及检测方法、检测条件带来的不确定度	正态, $k=2$	0.686kg	-0.0127kg^{-1}	0.871%
1.1	$u(\Delta)$	标准器引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.289kg	1	0.289kg
1.2	$u(d)$	测量管径引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.289mm	2	0.578mm
1.3	$u(t)$	检测时间引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.058s	1	0.058s
1.4	$u(\Delta t)$	启停不同步引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.289s	1	0.289s
1.5	$u(x)$	其它因素引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.231kg	1	0.231kg
2	$u(Q)$	被检器带来的不确定度	正态, $k=2$	0.178kg	0.0125kg^{-1}	0.223%
2.1	$u(\delta)$	被检器分辨力引入的不确定度	均匀, $k=\sqrt{3}$	0.0006kg	1	0.0006kg

2.2	$u(rep)$	重复性引入的不确定度	-	0.225kg	1	0.225kg
3	合成标准不确定度 $u_c(E)=0.871\%$					
4	扩展不确定度 $U(E)=1.74\%$, $k=2$					

D.4.2.2 合成标准不确定度 $u_c(E)$

以上各标准不确定度分量相互无关，合成标准不确定度为：

$$u_c(E) = \sqrt{C_1^2 u^2(Q) + C_2^2 u^2(Q_s)} = \sqrt{(0.0125)^2 \times 0.178^2 + (-0.0127)^2 \times 0.686^2} \times 100\% \\ = 0.871\%$$

D.4.3 校准结果的扩展不确定度 U

取 $k=2$ ，采用标准表法（外夹式超声流量计）校准结果的扩展不确定度为：

$$U = k u_c(E) = 2 \times 0.871\% \approx 1.74\%, \quad k=2。$$